

2023年8月  
(2023-35)

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。  
さてこの度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承いただき、今後ともより一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 変更実施日

2023年9月19日（火）ご依頼分より


◆ 検査内容変更項目一覧

No.1

検査項目名	変更箇所	新	現	備考
【2904】亜鉛 (Zn)	検査方法	比色法	原子吸光法	基準値、報告単位等に変更はございません。
	所要日数	1～2	3～4	
	採取容器	① 生化学（汎用） スピッツ（分離剤入り）	⑩金属専用容器	

※ディスポーザブル採血管のゴム栓、注射筒のピストン先端部に使われているゴム等、亜鉛が含まれているものがあります。採血管の選択には弊社指定の生化学スピッツ（分離剤入り）採血管で提出してください。

相関図

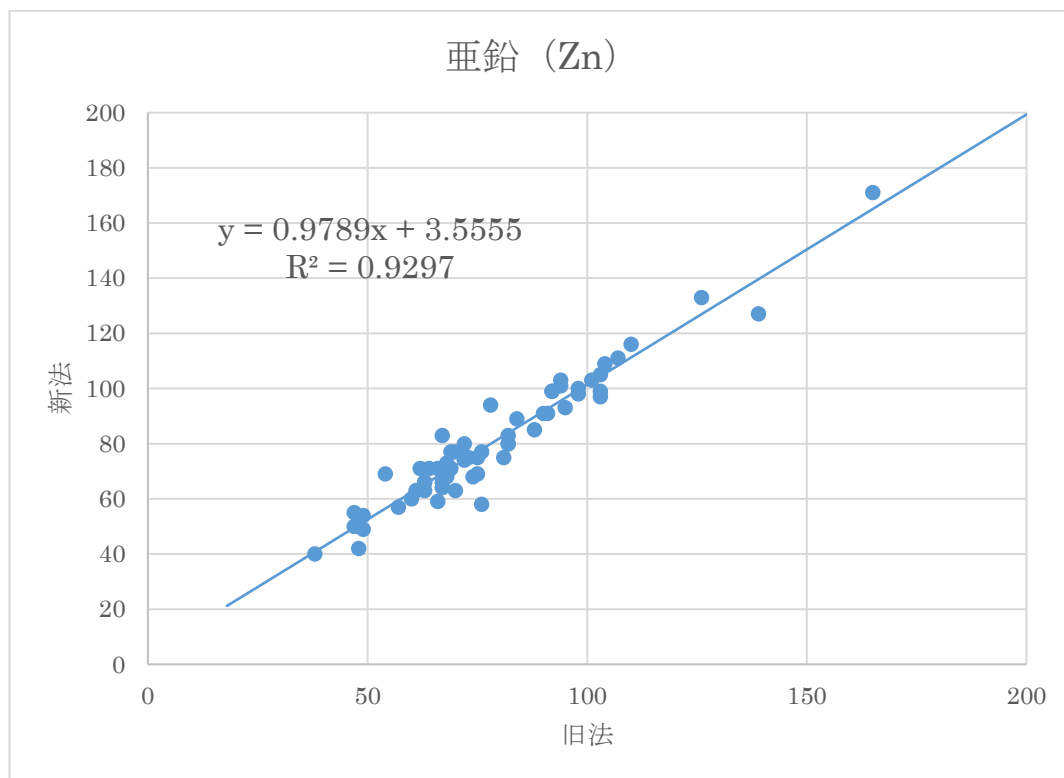

※その他以下の金属関連項目のご依頼時は、従来通り金属専用容器のご提出をお願い致します。

(検査案内本2022 P13)

【1979】アルミニウム 【3024】セレン 【3026】マンガン 【3069】クロム

【3177】ニッケル 【5788】亜鉛 (尿中)